Desinfektionsplan

Desinfektionslösungen gigasept® Instru AF

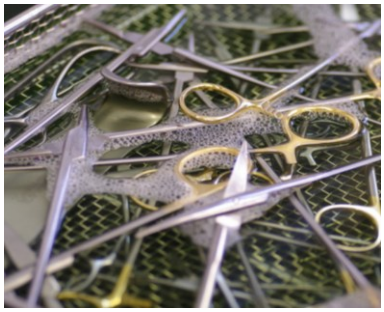

gigasept® instru AF ist ein aldehydfreies, kombiniertes Desinfektions- und Reinigungspräparat für chirurgischer Instrumente, Anästhesiezubehör, etc.

Allgemeines Desinfektionslösungsbad Instrumentenwanne 2 %

60 ml gigasept® Instru AF und 2940 ml normales Wasser = 3000 ml **2 %igen Lösung**
Einlegezeit: 30 Minuten
Standzeit der Gebrauchslösung: 1 x Wöchentlich*

Allgemeines Desinfektionslösungsbad Instrumentenwanne 3 %

90 ml gigasept® Instru AF und 2910 ml normales Wasser = 3000 ml **3 %igen Lösung**
Einlegezeit: 15 Minuten
Standzeit der Gebrauchslösung: 1 x Wöchentlich*

*Lösung wechseln **gigasept® Instru AF**			
wann	wer	wann	wer

Beispiel: Für das Ansetzen von 1 l einer 2 %-igen Gebrauchslösung werden 20 ml Konzentrat auf 980 ml Wasser gegeben.

Anwendungsmethoden / -hinweise
gigasept® Instru AF wird als Konzentrat geliefert und kann problemlos mit Wasser zu den in den Tabellen angegebenen Konzentrationen verdünnt werden. Hohlkörper so einlegen, dass Luft aus den Lumen vollständig entweicht und alle Oberflächen benetzt sind. **Einwirkzeiten und Einsatzkonzentrationen nicht überschreiten!**
Nach der Einwirkzeit desinfizierte Gegenstände gründlich unter fliessendem Wasser abspülen. Gigasept® Instru AF sollte aufgrund der guten Reinigungsleistung nicht mit Reinigungsprodukten abgemischt werden.
Beim Umgang mit Konzentraten ist grundsätzlich eine Schutzbrille zu tragen.

Wichtig! *Standzeit
Es gilt eine Standzeit von 7 Tagen, wenn die Anwendungslösung ausschliesslich zur Desinfektion vorher gereinigter Instrumente eingesetzt wird. Wenn die Anwendungslösung zur Reinigung eingesetzt wird, ist diese arbeitstäglich und bei deutlich sichtbarer Kontamination zu ersetzen.

Schülke & Mayr AG I Hungerbüelstrasse 22 I 8500 Frauenfeld I Tel. 044 / 466 55 44 I **E-Mail: mail.ch@schuelke.com**
www.schuelke.ch
Fatmir Hoti 24.01.2025